⚠📖

Brugermanual:

Ride™ Corbac™ justerbar rygstøtte

Ride Designs®
en filial af Aspen Seating, LLC

8100 SouthPark Way
Littleton, Colorado 80120 USA

frikaldsnummer (kun USA): 866.781.1633
telefonnummer: 303.781.1633
www.ridedesigns.com

Leverandør: Denne manual skal overrækkes til produktets slutbruger, da den indeholder vigtige informationer om korrekt brug af dette produkt.

Bruger: Læs hele manualen grundigt, inden du bruger produktet, og opbevar den til fremtidig brug.

Tilsigtet brug og monteringsinstruktioner

Tilsigtet brug

Din Ride Designs® Corbac™ justerbare rygstøtte er blevet omhyggeligt fremstillet for at opfylde dine behov, hvad angår holdning og hud, og til montering på kørestoler af flere typer og størrelser for at hjælpe med at støtte og anbringe brugerne af kørestolen i korrekt stilling.

Maks. vægt

Maks. brugervægt er 113 kg.

Generel produktsikkerhed

Sikker anvendelse af dette produkt afhænger af din gode dømmekraft og almindelig sund fornuft, tillige med din leverandørs, plejepersonalets og/eller sundhedspersonalets, samt din opmærksomhed i at følge forholdsreglerne, noterne og instruktionerne i denne manual.

BEMÆRK: Vi har udarbejdet denne manual fra de sidste nye specifikationer og produktoplysninger, som var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer, når disse viser sig at være nødvendige. Enhver ændring til vores produkter kan eventuelt medføre mindre variationer mellem billederne og forklaringerne i denne manual og det produkt, som du har købt.

⚠ ADVARSEL: Alle Ride Desings støtteoverflader er udviklet til at hjælpe med at reducere forekomsten af tryksår. Ingen rygstøtte kan imidlertid helt bortskaffe siddetryk eller forebygge tryksår. Ride Corbac er ikke en substitut for god hudpleje, heriblandt hensigtsmæssig kost, renlighed og jævnlige trykaflastningsteknikker.

FORSIGTIG: Manglen på at overholde forholdsregler kan eventuelt forårsage skade på dit produkt.

⚠ Læs venligst denne manual, inden produktet bruges.

⚠ Alle Ride Designs støtteoverflader er udviklet til at hjælpe med at reducere forekomsten af tryksår. Ingen rygstøtte kan imidlertid helt bortskaffe siddetryk eller forebygge tryksår. Ride Corbac er ikke en substitut for god hudpleje, heriblandt hensigtsmæssig kost, renlighed og jævnlige trykaflastningsteknikker.

⚠ Montering af ethvert ryglæn kan ændre dit tyngdepunkt på kørestolen. En tilbagetrukket rygposition kan eventuelt medføre, at kørestolen tipper bagud, og potentielt resultere i kvæstelser. Man skal altid vurdere om det er nødvendigt at montere anti-tip beslag eller akseladapter-beslag til amputationspatienter på din kørestol for at hjælpe med at øge stabiliteten. På lignende måde kan en mere fremadgående rygposition reducere kørestolens fremadgående stabilitet, og øge risikoen for at tippe fremad, med mulighed for kvæstelser.

⚠ Brug ikke din Corbac uden første at montere netdækkenet.

⚠ Løft ikke kørestolen ved brug af Corbac.

⚠ Uhensigtsmæssig placering eller fastgørelse af Ride Corbac på din kørestol, kan eventuelt føre til kvæstelser.

⚠ Dette produkt skal monteres og tilpasses af kvalificeret og kompetent sundhedspersonale. Mangel på nøjagtigt at bedømme og justere størrelsen på Corbac, kan eventuelt resultere i personskader.

Monterings- og brugsvejledninger

Det anbefales, at en terapeut eller autoriseret leverandør af Ride Designs foretager den indledende tilpasning af din rygstøtte. Din Ride Corbac er designet til at forbedre stabiliteten af kropsstammen ved at yde bag- og lateral støtte til underkroppen, columna lumbalis og bækken (dvs. stammen). Corbac justerbare ramme bruger stropper til at opnå den indledende støtte til balance og justering. Bryst-lænde-bækken (TLP) støtter yder ekstra bag-lateral støtte, og netdækkenet fra Corbac yder en letvægts støddæmpende støtte for at lette transport af fugt og samtidig reducere forskydning.

Corbac består af fire komponenter: 1) Den justerbare ramme, 2) to bryst-lænde-bækken (TLP) støtter, 3) netdækkenet og 4) fire monteringsklemmer.

Bestem de hensigtsmæssige monteringsinstruktioner

Inden monteringen skal den nødvendige konfiguration bestemmes, og man skal gå videre med det korrekte afsnit i manualen:

❑ Hvis man skal udskifte en stropryg på en kørestol UDEN skubbehåndtag, henvises der afsnittet, der hedder "Udskift eksisterende stropryg på en kørestol uden skubbehåndtag."

❑ Hvis man skal udskifte en stropryg på en kørestol, der har rygrør med indbyggede skubbehåndtag og eksisterende gevindskårne indlæg, henvises der til afsnittet, som hedder "Udskift eksisterende stropryg på en kørestol med skubbehåndtag og eksisterende gevindskårne indlæg."

❑ Hvis man skal udskifte en stropryg på en kørestol med indbyggede skubbehåndtag, men UDEN gevindskårne indlæg, henvises der til afsnittet, der hedder "Udskift stropryg på en kørestol, som har rygrør med indbyggede skubbehåndtag, men uden eksisterende gevindskårne indlæg."

❑ Hvis Corbac monteres over eksisterende stropryg henvises der til afsnittet, som hedder "Montering af Corbac over eksisterende stropryg."

Montering af Corbac

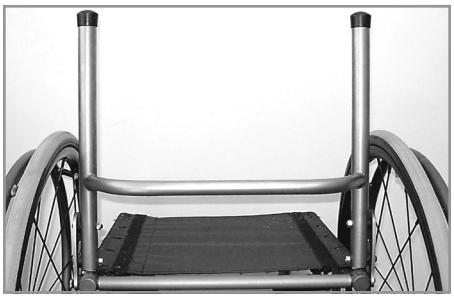

Udskift den eksisterende stropryg på en kørestol uden skubbehåndtag

1. Tag den eksisterende stropryg af kørestolen.
2. Justér højden på rygrøret (hvis relevant) til den ønskede højde for rygstøtten.
3. Lad Corbac justerbare ramme glide ned over kørestolens rygrør.

   a. Tag Corbac justerbare ramme ud af papemballagen. Fold den ikke ud.

   b. Find frem til rygrørets lommer langs indersiden af rygpanelet og under justeringsstropperne. Reflekterende bånd angiver åbningen af rørlommerne.

   c. Lad Corbac justerbare rørlommer glide over kørestolens rygrør. (Du skal muligvis løsne de justerbare stropper let).

   ⚠ Mangel på at bruge rygrørets lommer kan føre til, at Corbac glider ned ad rygrørene og resultere i personskader.

4. Stram justeringsstropperne let. På enkelte stive kørestolsmodeller findes der eventuelt en eller flere justeringsstropper forneden under stabiliseringsstangen.
5. Træk nedad og fastgør overgangsdækket til sædestroppen, og sørg for tilstrækkelig slæk, så puden kan placeres mod rygrørene.
6. Montér sædehynden ved at sikre den korrekte placering.
7. Gå videre med afsnittet, der hedder "Montering af Corbac."



Udskift eksisterende stropryg på en kørestol med skubbehåndtag og eksisterende gevindskårne indlæg.

1. Kontrollér, at Corbac bruges uden rullestolens originale rygpolstring og, at rygrørene er udstyret med skubbehåndtag (A) og gevindskårne indlæg (B), som vist på billede 1.

2. Tag Corbac justerbare rygstøtte ud af papemballagen. Fold den ikke ud.

3. Find frem til den store lomme under justeringsstropperne.

4. Lad Corbac justerbare rygstøtte glide over kørestolens skubbehåndtag ved at skubbe håndtagene gennem hullerne i den store lommes hjørner foroven og i siden.

5. Juster ringene på Corbac rygstøtten med det originale gevindskårne indlæg på kørestolen.

6. Indsæt skruerne fra den originale rygpolstring gennem ringene og ind i det gevindskårne indlæg, og stram på sikker måde (billede 2).

7. Stram Corbac fastspændingsstropper let. På enkelte stive kørestolsmodeller findes der eventuelt en eller flere justeringsstropper forneden under stabiliseringsstangen.

8. Træk nedad og fastgør overgangsdækket til sædestroppen, og sørg for tilstrækkelig slæk, så sædehynden kan placeres mod rygrørene.

9. Montér sædehynden ved at sikre den korrekte placering.

10. Gå videre med afsnittet, der hedder "Montering af Corbac."

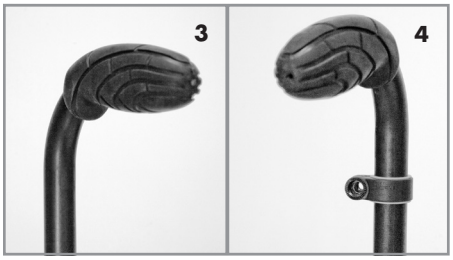

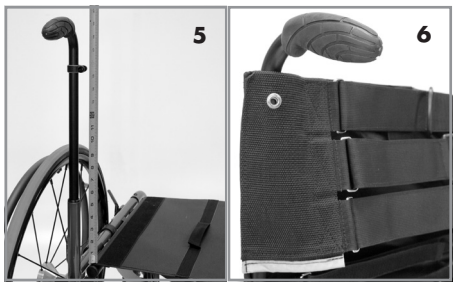

Udskift stropryg på en kørestol, der har rygrør med indbyggede skubbehåndtag, men uden eksisterende gevindskårne indlæg

1. Kontrollér, at Corbac bruges uden rullestolens rygpolstring og, at rygrørene er udstyret med skubbehåndtag, men uden gevindskårne indlæg (billede 3).

2. Bestem rørdiameteren i den position, hvor toppen af Corbac-højden skal anbringes.

3. Brug følgende klemmer til din rørdiameter:

1" rør ..... Store klemmer uden mellemlæg

7/8" rør ..... Store klemmer med mellemlæg

3/4" rør ..... Små klemmer med mellemlæg

4. Med klemmens skrueindlæg mod bagsiden af kørestolen, monteres klemmerne ved at sprede klemmerne over rørene (billede 4). Juster klemmehøjden til ¾" under den endelige Corbac-højde og sørg for, at begge klemmer er på samme højde over sædeskinnerne (billede 5). Monter ikke skruerne endnu.

5. Monter den justerbare Corbac rygstøtte.

a. Tag Corbac justerbare ramme ud af papemballagen og frigør stofdækkenet. Fold den ikke ud. Find frem til de store lommer under de justerbare stropper.

b. Lad Corbac justerbare ramme glide over kørestolens skubbehåndtag og klemmer ved at skubbe håndtagene gennem hullerne i den store lommes hjørner foroven og i siden (billede 6).

c. Juster den justerbare rammes huller med klemmerne og indsæt de medleverede 10-32 skruer. Juster klemmernes rotation, så de passer til den justerbare rammes ønskede kurve. Stram skruerne på sikker måde (billede 7).

6. Stram stropperne let. På enkelte stive kørestolsmodeller findes der eventuelt en eller flere justeringsstropper forneden under stabiliseringsstangen.

7. Træk nedad og fastgør overgangsdækket til sædet, og sørg for tilstrækkelig slæk, så sædehynden kan placeres mod rygrørene.

8. Monter sædehynden ved at sikre den korrekte placering.
9. Gå videre med afsnittet, der hedder "Montering af Corbac."

Monter Corbac over den eksisterende stropryg

1. Lad den eksisterende stropryg blive siddende på kørestolen.
2. Monter Corbac justerbare ramme.
   a. Tag Corbac justerbare ramme ud af papemballagen. Fold den ikke ud.
   b. Find frem til den store lomme under justeringsstropperne.
   c. Lad Corbac justerbare ramme glide over kørestolens stropryg. Sørg for at den eksisterende stropryg er indsat i den store lomme (du skal eventuelt slække på stropperne).
3. Stram stropperne let. På enkelte stive kørestolsmodeller findes der eventuelt en eller flere justeringsstropper forneden under stabiliseringsstangen.
4. Træk nedad og fastgør overgangsdækket til sædestroppen, og sørg for tilstrækkelig slæk, så sædehynden kan placeres mod rygrørene.
5. Montér sædehynden ved at sikre den korrekte placering.
6. Gå videre med afsnittet, der hedder "Montering af Corbac."

8


9

10

Montering af Corbac

1. Overførsel på kørestolen.
2. Juster stropperne på rammen for optimal balance og justering af kroppen (billede 8).
3. Juster bryst-lænde-bækken (TLP) støtterne (billede 9).
   a. Læn dig fremad og anbring TLP-støtterne (spidserne vender indad) mod din krop på den ønskede position i det lumbale-sakrale område.
   b. Læn dig tilbage for at fastgøre kilerne til den justerbare rammes forreste overflade ved brug af krogen og burrelukket.
   c. TLP-støtterne kan bevæges op/ned, ind/ud og roteres. I nogle tilfælde kan de gå ud over bredden på kørestolens ramme og kan forkortes.
   d. Gå videre med at foretage justeringer til TLP-støtterne, indtil den ønskede kropsholdning og komfort opnås.
4. Monter netdækkenet (billede 10).
   a. Læn dig fremad og træk netdækkende over den justerbare ramme og TLP-støtterne.
   b. Fastgør krogen indvendigt forneden/foroven på dækkenet for til burrelukket på forsiden af den justerbare ramme.
   c. Læn dig tilbage og fastgør dækkenets fire stropper med burrelukke til bagsiden af den justerbare rammes stropper.
   d. Træk netdækkenets bagklap over den justerbare rammes stropper. Burelukkerstrimler på bagklappen vil fæstne sig til bagsiden af den justerbare rammes stropper.
   e. Genjustering af TLP-støtter er eventuelt nødvendigt efter placering af dækkenet. Man skal blot tage dækkenet af, justere positionen af TLP-støtterne, og genmontere dækkenet.

Tidsplan for indledende brug

Inden du sidder i længerevarende perioder, tilrådes det at bruge din Ride Corbac i løbet af korte tidsrum, og visuelt kontrollere ethvert område, der berører rygstøtten. Enhver form for rødme bør forsvinde inden for 10-30 minutter. Kontakt din læge eller terapeut, hvis rødmen vedvarer i mere end 30 minutter. Så længe kontrollerne af huden ikke viser områder med rødme, der varer mere end 30 minutter, kan du roligt fortsætte brugen. man skal kontrollere huden mindst en gang dagligt, selv efter huden er blevet tolerant. Fortsæt med at udføre jævnlige trykaflastningsteknikker (læne fremad), som tilrådet af dit sundhedspersonale.

⚠ ADVARSEL: Hvis nogen rødme i forbindelse med brugen af Corbac vedvarer i mere end 30 minutter, ophør straks med brugen og kontakt din terapeut eller læge.

Opfølgning

Det anbefales at du får din siddeposition og hud kontrolleret af dit sundhedspersonale mindst en gang om året, eller så snart du oplever en ændring i din vægt, kropsholdning eller overordnet tilstand, der eventuelt kunne påvirke din evne til at sidde på en sikker, bekvem og funktionsdygtig måde.

Vaskesymboler	
40	Maskinvask varmt vand (40 °C)
40	Må ikke bleges
III	Skal dryptørre
⊗	Må ikke tørrenses
⊘	Må ikke stryges

Pleje og vedligeholdelse af din Ride Corbac

Rengøring af Corbac netdækken

- Tag netdækkenet af Corbac.
- Hægt krog/burrelukker til hinanden. Anbring i en pose med lynlås
- Vask med varmt vand i maskine eller hånden (normal sæbe/intet blegemiddel).
- Skal dryptørre

Rengøring af Corbac justerbare ramme

brug en fugtig klud eller mildt rensemiddel, rens overgangsdækket, TLP-støtterne og de grundlæggende komponenter efter behov.

FORSIGTIG: Rengør ikke din Corbac med isopropanol eller andre kemiske opløsningsmidler.

Sikkerhed under kørsel i bil

⚠ RISIKO FOR PERSONSKADE: Corbac er IKKE blevet dynamisk testet for brug i en bil. Sæt ikke din lid til en Corbac for sikker støtte i tilfælde af kollision i en bil. Alvorlige kvæstelser eller dødsfald kan forekomme i forbindelse med et biluheld, hvis ikke bilens hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger bruges.

1. Flyt dig altid ud af din Corbac og brug bilfabrikantens originale sæde og tilbageholdelsesanordninger under kørslen.

Vedligeholdelse

Corbac og fastgørelserne skal kontrolleres jævnligt mindst hver 6. måned for løse, manglende eller beskadigede fittings og hensigtsmæssig funktion. Kontrollér og stram alle komponenter i henhold til denne manual. Kontakt din autoriserede Ride designs-leverandør vedrørende beskadigede eller manglende komponenter.

⚠ Fortsæt IKKE med brugen af dit produkt med løse, manglende eller beskadigede komponenter.

Produktlevetid

Maks. tilsigtet anvendelse af dette produkt er fire år.

Genbrug

⚠ RISIKO FOR PERSONSKADER: Rådfør med en autoriseret Ride Designs-forhandler, inden du overdrager til en anden bruger. Brug IKKE produktet, hvis der findes nogen form for skade.

Bortskaffelse

♻ Genbrug komponenter og materialer i henhold til lokale, regionale og nationale bestemmelser.

Garanti

Din Ride Designs® Corbac™ justerbare rygstøtte er blevet omhyggeligt fremstillet for at opfylde dine behov, hvad angår kropsstilling og hud. Denne begrænsede garanti er gældende i 24 måneder fra datoen for levering til den originale køber. Hvis der findes nogen defekt i materiale eller kvalitet, reparerer eller erstatter Ride Designs komponenten efter eget skøn. Denne begrænsede garanti dækker ikke normalt slid eller skader, der opstår som følge af fejlhåndtering, misbrug, forsømmelse eller mangel på at følge pleje- og vedligeholdelsesinstruktionerne.

Reklamationer og reparationer skal behandles gennem din nærmeste autoriserede Ride Designs leverandør. En kopi af slutsedlen, der er udstedt til produktets køber, er eventuelt nødvendigt inden en garantireklamation behandles.

Ride Corbac rygstøtte fungerer bedst, når den bruges med en supplerede Ride designs pude

Ride Forward puden egner sig mest til personer med mild til moderat risiko for hudlæsioner.

Opnå en høj grad af hudbeskyttelse og funktionel ydeevne med **Ride Java puden** (kun Ride Custom puden kan yde en større grad af beskyttelse og støtte).

For personer med øget risiko for hudlæsioner og/eller mere udfordrende behov for kontrol af kropsholdning, er **Ride Custom puden** den ultimative løsning i holdningsmæssig støtte og hudpleje. Den er specifikt udformet til at støtte en persons unikke størrelse, form, kropsholdning og funktionelle krav. Fås kun i USA.

Flere informationer om hele sortimentet af Ride Designs puder findes på www.ridedesigns.com.

Monteringsnoter

Patenter: www.ridedesigns.com/patents
© 2015, Ride Designs. 090-005-B

CE

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Tyskland